

NOME DO PRODUTO: LÂMINA PARA MICROSCOPIA - WILTEX

Registro MS: ISENTO

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Lâmina para microscopia lisa

Matéria Prima: Vidro

Método de Esterilização: Não estéril

Produto Estéril: () Sim (x) Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Produto confeccionado em vidro, oferecendo transparência ideal para microscopia, descartável, não forma lascas e nem rebarbas, boa fixação de identificação na parte fosca, boa fixação do material após realização de técnicas adequadas.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado para microscopia entre outras utilizações laboratoriais.

INSTRUÇÃO DE USO

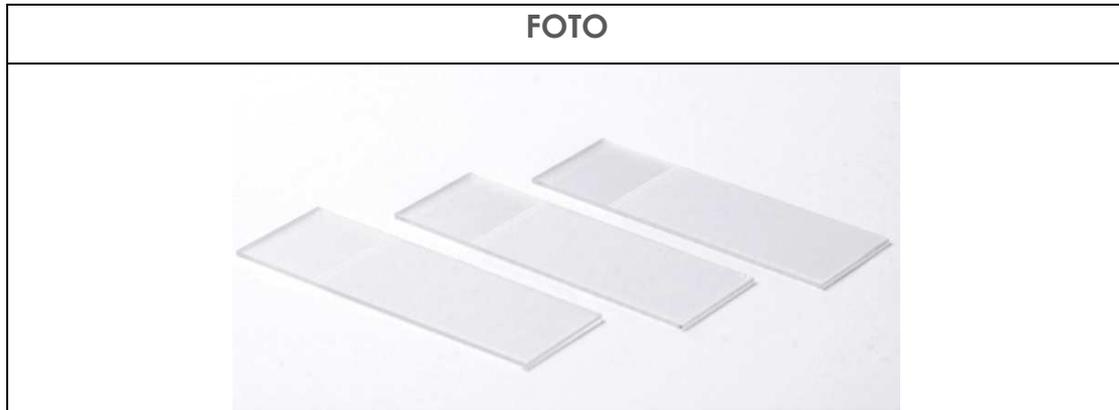
O produto deve ser utilizado por profissional qualificado

Deve-se observar a integridade da embalagem

Seguir protocolo da instituição de acordo com a técnica indicada para o procedimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho: 25,4 x 76,2 mm (1''x 3''). Espessura 1 mm – 1.2 mm

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7105	Lâmina para Microscopia Fosca lapidada
7105-1	Lâmina para Microscopia Fosca não Lapidada
7101	Lâmina para Microscopia Lisa Lapidada
7102	Lâmina para Microscopia Lisa não Lapidada

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Caixa com 50 unidades

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local fresco e seco

PRECAUÇÕES/ CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou danificada;

Não deve ser reutilizado. É de uso único

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259